


遠隔監視モニターデータ収集

オプション価格35万～(設置環境の事前見積が必要)

LAN接続・モバイルWi-Fiに接続された試験状況を離れたパソコンでモニター等が可能

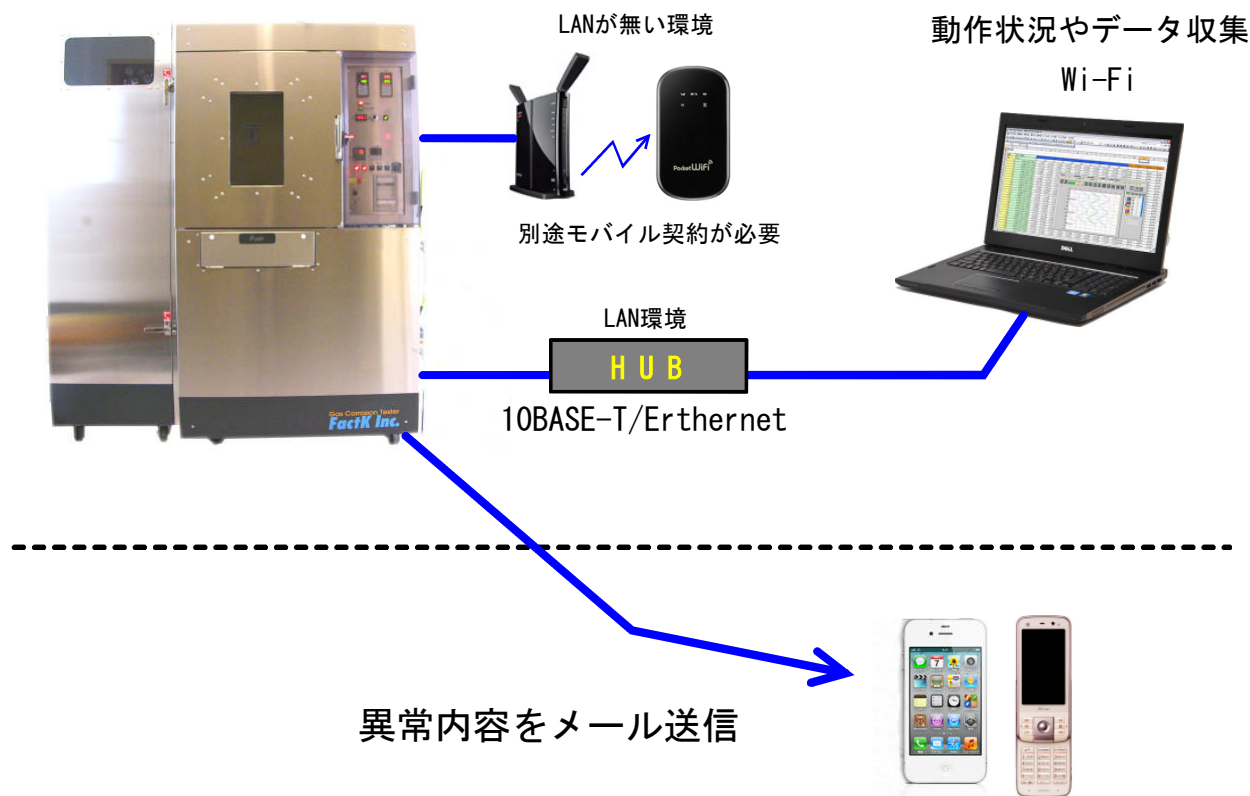

遠隔監視警報システム

オプション価格55万～(設置環境の事前見積が必要)

装置に異常が発生した場合、下記の状況を指定先へメール送信し察知することが可能です

1. 非常停止ボタンが押された場合
2. シリンダー元栓が遮断した場合
3. 給水タンクなどの漏水の場合(タンク給水方式の場合)
4. 試験機温度が異常上昇した場合
5. 排水タンクが限界水位になった場合(タンク溜方式の場合)
6. 扉が開いた場合
7. 試験槽内設定温度異常の場合
8. 試験槽内設定湿度異常の場合
9. その他アラーム発生チャンネルの送信

アラーム発生時にメールを送る機能



※停電時でも状況送信する場合UPS(無停電電源)が別途必要となります